



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต.โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/๒๖๕

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจาก
ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีบันทึกข้อความที่ ดง ๐๐๓๔(๒)/๑๐๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดอากาศร่วมทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ จำนวน ๒ โรงงาน ได้แก่ (๑) บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๒๐๐๐๑๕๒๕๖๑๔ [๓-๓๔(๓)-๑๕/๖๑ตง] ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๕ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และ (๒) บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๒๐๐๐๐๗๒๕๕๘๗ [๓-๕๒(๔)-๗/๕๘ตง] ประกอบกิจการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ ๖ ถนนสายบางหมาก-สนามบิน ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัด ดังนี้

๑. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่อง WESP จำนวน ๑ ปล่อง ของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานผลิตไม้อัดได้ ๔๘ ต้นต่อชั่วโมง (กำลังการผลิตสูงสุด ๖๐ ต้นต่อชั่วโมง) โดยแบบแผนสรุปผลการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ เนื่องจากโรงงานแจ้งหยุดการผลิต ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบ ๒๔ ชั่วโมง ตามวิธีมาตรฐานกำหนด

๒. ตรวจวัดแก๊สในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๐ ตัน ของปล่อง D, E และ F จำนวน ๓ ปล่อง ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานทำการผลิตไอน้ำได้ ๒๑ ต้นต่อชั่วโมง ๒๔ ต้นต่อชั่วโมง และ ๑๖ ต้นต่อชั่วโมง ตามลำดับ (กำลังการผลิตสูงสุด ๓๐ ต้นต่อชั่วโมง) โดยแบบแผนสรุปผลการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับการกำหนดยกเว้นและหรือผ่อนผันระบบ CEMS

ชื่อโรงงาน	บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน	10920001525614 [3-34(3)-15/61ตง]
ที่อยู่	เลขที่ 222 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ต.ควนเมา อ.รัชฎา จ.ตรัง 92160

ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ อก.0310(7)/3725
 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2568
 เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยการผลิตที่ยกเว้นไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ

☐	กรณีที่ 1	เข้าข่าย Time sharing อุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา ปล่อง..... ในรายการ.....
☒	กรณีที่ 2	เข้าข่าย 4(1) ค่าการระบายมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน ในระดับ 10% ปล่อง ปล่องระบาย WESP ในรายการ ฝุ่นละอองในปล่องระบาย ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)
☐	กรณีที่ 3	เข้าข่าย 11(3) ชนิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ₂ ในเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ ปล่อง.....
☐	กรณีที่ 4	เข้าข่าย ไม่สามารถเจาะปล่องระบายโรงงานได้ เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้างปล่องระบาย ปล่อง.....

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปล่องWESP.....

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
	ปล่อง WESP
ฝุ่นละอองในปล่องระบาย (mg/m ³)	54
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ppm)	7
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm)	9
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)	ไม่พบ

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความเข้มข้นของ ฟูลเลอโรในปล่องระบาย มีค่า 16.9 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 320 mg/m³)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่า 3.5 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 200 ppm)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ คาร์บอนมอนอกไซด์ มีค่า 1.3 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 690 ppm)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่า 0 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 200 ppm)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาด
(ชัยพุดติน พันกาด)
นักวิทยาศาสตร์

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘


(นายอิวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับการกำหนดยกเว้นและหรือผ่อนผันระบบ CEMS

ชื่อโรงงาน	บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนโรงงาน	10920000725587 [3-52(4)-7/58ตง]
ที่อยู่	ถ.สายบางหมาก-สนามบิน ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง

ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ อก 0310/12022 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยการผลิตที่ยกเว้นไม่ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ และขอความเห็นชอบติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา (Time sharing) และขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ		
☒	กรณีที่ 1	เข้าข่าย Time sharing อุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา ปล่อง..... ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D E และ F ในรายการ..... ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) และออกซิเจน (O ₂) ปล่อง..... ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D และ F ในรายการ..... คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปล่อง..... ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง E และ F ในรายการ..... ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)
☒	กรณีที่ 2	เข้าข่าย 4(1) ค่าการระบายมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน ในระดับ 10% ปล่อง..... ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D E และ F ในรายการ..... ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ₂
☐	กรณีที่ 3	เข้าข่าย 11(3) ชนิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ₂ ในเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ ปล่อง..... -
☐	กรณีที่ 4	เข้าข่าย ไม่สามารถเจาะปล่องระบายโรงงานได้ เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้างปล่องระบาย ปล่อง..... -

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และออกซิเจน (O₂)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D E และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	ปล่อง D	ปล่อง E	ปล่อง F
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	78	88	104
ออกซิเจน (O ₂)	13.71	15.33	14.86

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความแตกต่างของ ออกไซด์ของไนโตรเจน ของปล่อง D และ E มีค่า 12.0% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกไซด์ของไนโตรเจน ของปล่อง D และ F มีค่า 28.6% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกไซด์ของไนโตรเจน ของปล่อง E และ F มีค่า 16.7% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกซิเจน ของปล่อง D และ E มีค่า 11.2% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกซิเจน ของปล่อง D และ F มีค่า 8.1% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกซิเจน ของปล่อง E และ F มีค่า 3.1% (กำหนดไม่เกิน 20 %)

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ปล่อง D	ปล่อง F
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	23	143

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความแตกต่างของ คาร์บอนมอนอกไซด์ ของปล่อง D และ F มีค่า 144.6% (กำหนดไม่เกิน 20 %)

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง E และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ปล่อง D	ปล่อง F
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความแตกต่างของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง E และ F มีค่า 0% (กำหนดไม่เกิน 20 %)

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 2

ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D E และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	ปล่อง D	ปล่อง E	ปล่อง F
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง D มีค่า 0% ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 60 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง E มีค่า 0% ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 60 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง F มีค่า 0% ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 60 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพฤตินันท์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘


(นายอริวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สอง.ต.ร. (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) โทร. ๐-๗๔๔๒-๔๔๔๔ Email : moi-brang@industry.go.th

ที่...ตง.๐๐๓๔(๒)/๖๐๘๗

วันที่...๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง...ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายนมลพิษอากาศจาก
ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS. (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กต.สปอ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายนมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจุฑารัตน์ อาวรัตน์ถาวร)
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ว่าที่ร้อยตรี (ชัยพฤกษ์ พันกานต์)
นักวิทยาศาสตร์
13 มิ.ย. 2568

คุณ อธิวัฒน์/คุณ กนกพร
เรื่อง ๐๐๓๔(๒)/๖๐๘๗

นางสาวจุฑารัตน์ อาวรัตน์ถาวร
(นางสาวจุฑารัตน์ อาวรัตน์ถาวร)
ผู้อำนวยการ

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 22 พ.ค. 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ แสนไพร่ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
 พร้อมด้วย นายสุเมธ ใจดี นายสุวิทย์ ใจดี นายสุวิทย์ ใจดี นายสุวิทย์ ใจดี
 สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 พร้อมด้วย นายพรชัย หิมมาตร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ชัยภูมิ ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท สยาม อีโคโนมิก โซลูชั่น จำกัด อีอีเอส
 ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓๐๐๐๐๐๕๔ (3-34(๖)-16/1 ๖) ประกอบกิจการ ผลิตน้ำตาล (Pesticide Brand) ลงชื่อ นาย
 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖๖ ถนน พหลโยธิน หมู่ ๑๐๖ ตำบล ตาคลี อำเภอ วิเศษ
 จังหวัด ชัยภูมิ เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สไฮโดรเจน ใน ถังเก็บ
 เมื่อวันที่ ๖ เวลา ๐๘.๐๐

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี ท.ศ. พิธิรักษ์ณ์ เสือทอง ตำแหน่ง Safety Specialist เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ เก็บตัวอย่างของ ฝุ่นละออง ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของโรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สและฝุ่นละอองตามจุดตรวจวัดบริเวณ อ.โกสุมพิสัย
พบค่าความหนา 15 มก/ลบ.ม. ที่ระยะ 48 ซม./ชั่วโมง (แก๊สพิษชนิดไฮโดรเจน 60 ซม./ชั่วโมง)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

12/11/20

ใบสำเนาเก็บตัวอยู่ ณ คณะนิติแพทยศาสตร์
เมื่อตรวจโรครานแล้วแพทย์ พลับโพธิ์ 23 พ.ย. 69
ทำใบสำเนาเก็บตัวอยู่ ณ คณะ 24 พ.ย.
ทางแพทย์ พลับโพธิ์

နေ့ဂါးစံ ၁၆ မက

$$10.9 \text{ mm} \times 7350 \text{ mm} \times 2465 \text{ mm} = 0.279 \frac{\text{m}^3}{112 \text{ m}^3}$$

mass of water 650 kg/m³

$$\text{line speed} = \frac{550 \text{ mm/s} \times 3600 \text{ s/hr.}}{7350 \text{ mm/rev}} = 268 \text{ rev/hr.}$$
$$Q. 279 \frac{m^3}{hr} \times 269 \frac{kg}{m^3} \times 660 \frac{kg}{m^3} = 48.3 \frac{Ton}{hr}.$$

ลงชื่อ พิงศักดิ์ ผู้นำตรวจ
 (พงศกร พิงศักดิ์ ๑๕๐๖.๑๖)

ตำแหน่ง Safety Specialist

ลงชื่อ: ผู้ตรวจวัด
(นายสุวิทย์ นิลนิคม)

ตำแหน่ง วิศวกรปิโตรเลียม

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายพรสิทธิ์ ชื่นหาญ)

ตำแหน่ง รองกรรมาธิการ

ว่าที่ร้อยตรี เกียรติ วัฒนากุล

(ชัยพฤกษ์ดิน พันกาแด)

นักวิทยาศาสตร์

13. ધિ.ઇ. 2568



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ดริง (ประเทศไทย) จำกัด 10920001525614 [3- 34(3)-15/61ดง] ประเภทโรงงาน 34(3) ISIC 1621 TSIC 16210	222 ม.5 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403 ต.ควน เมา อ.รัชฎา จ.ตรัง 92160 	บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ดริง (ประเทศไทย) จำกัด 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110	ผลิตไม้อัด (Particle board) จากไม้ ยางพารา เครื่องจักร 159,260.50 HP เงินทุน 3,215,000,000 บาท คนงาน 287 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี ธีรภัฏ มณีมาจ
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
13 มิ.ย. 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..สอจ.ตรัง (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) โทร. ๐ ๗๕๔๒ ๕๕๕๐ Email.: moi_trang@industry.go.th

ที่..ตง.๐๐๓๔(๒)/๖๐๕๓

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายนํ้าเสียจากโรงงาน
ปล่อยระบายนํ้าที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัววัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายนํ้าเสียจากโรงงานปล่อยระบายนํ้าที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัววัดที่ ๑ ของโครงการ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจุฑาทิพย์ อาวรัตน์)
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ พันกาแด
(ชัยวุฒิ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

13 มี.ย. 2568

คุณอริวิทย์/คุณกนกพันธ์

เพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป

คุณ วิชาญ
(นางสาววิชาญ วิชาญ)

ผู้อำนวยการ

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 23 พ.ย. 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน
พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ นายสุวัฒน์ นายสุวัฒน์ นายสุวัฒน์ นายสุวัฒน์ นายสุวัฒน์
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรัง ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท สตีลดีปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๑๐๐๐๐๐๐๐๐ [3-๘๔-๗-๗๕๖] ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กดัด
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๕ ถนน สองแคว ตำบล บางนา อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สพิษ
เมื่อวันที่ เวลา

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี น.ส. จันทนา คำวิจิตร ตำแหน่ง ผจ. อำนวยการ
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ น.ส. จันทนา
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สพิษ พบว่า Boiler D ผลิตไอน้ำ ๒๐.๓ ตัน/ชั่วโมง
Boiler E ผลิตไอน้ำ ๒3.53 ตัน/ชั่วโมง Boiler F ผลิตไอน้ำ 16.61 ตัน/ชั่วโมง จากกำลังการผลิต
รวม ๖๐.๔๔ ตัน/ชั่วโมง

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

Boiler D ผลิตไอน้ำ ๒๐.๓๐ Ton/hr.

Boiler E ผลิตไอน้ำ ๒3.53 Ton/hr.

Boiler F ผลิตไอน้ำ 16.61 Ton/hr.

โดยเจ้าหน้าที่โรงงาน

เจ้าหน้าที่ :

วัสดุ : Bags filter + Multicyclone

ลงชื่อ ผู้นำตรวจ
(น.ส. จันทนา คำวิจิตร)
ตำแหน่ง ผจ. อำนวยการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจวัด
(นายสุวัฒน์)
ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน

ลงชื่อ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายสุวัฒน์)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี พันโท
(ชัยพฤกษ์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

13 มิ.ย. 2568



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10920000725587 [3- 52(4)-7/58ดง] ประเภทโรงงาน 52(4) ISIC 2219 TSIC 22199	85 ม.6 ถ.สายบางหมาก- สนามบิน ด.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 110 ถ.กาญจนวนิช ด.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 0 7520 1199	ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ เครื่องจักร 115,607.59 HP เงินทุน 3,200,000,000 บาท คนงาน 1,600 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ พันภาณ
(ชัยพฤดิษฐ์ พันภาณ)
นักวิทยาศาสตร์
13 มิ.ย. 2568


บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 10920000725587 [3-52(4)-7/58ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์

สถานที่ตั้ง 85 หมู่ 6 ถนนสายบางหมาก-สนามบิน ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 23 พฤษภาคม 2568

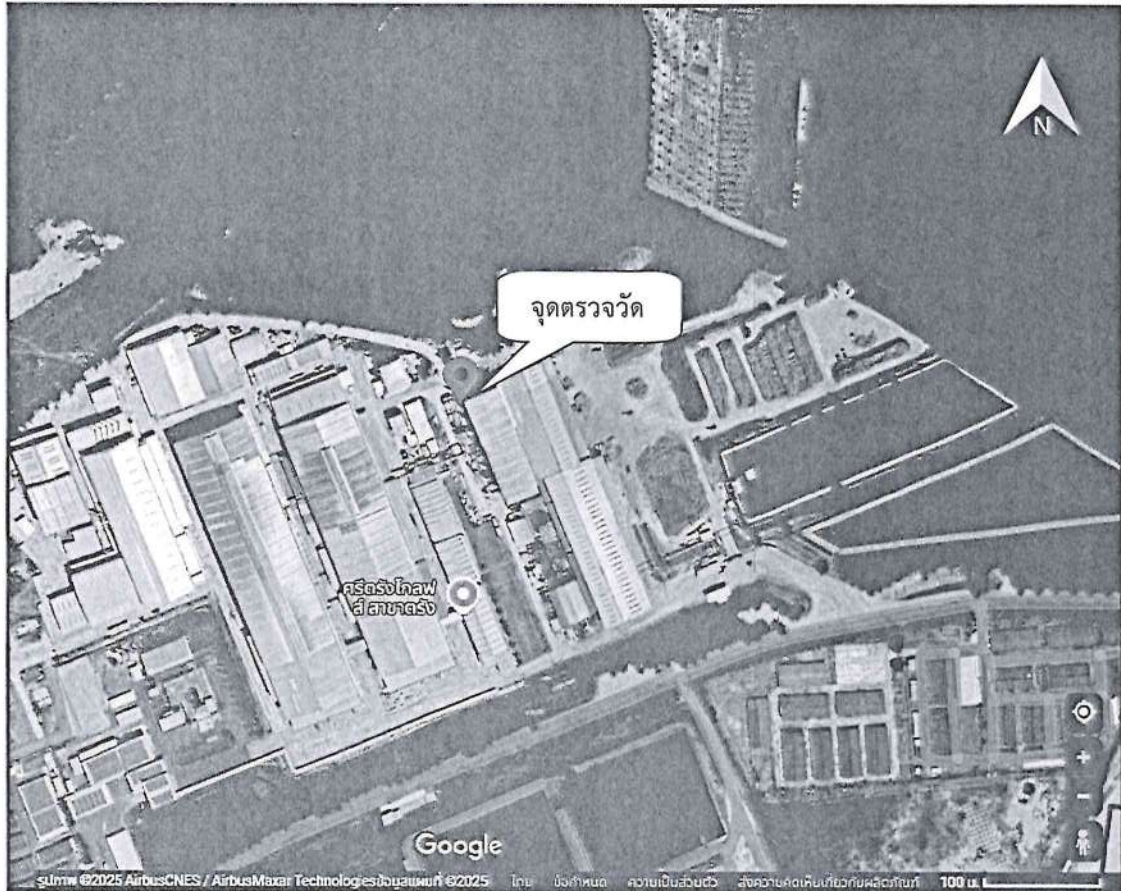

จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง F (GPS : N 7.498453 E 99.577786)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680526-00068


บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 10920000725587 [3-52(4)-7/58ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์

สถานที่ตั้ง 85 หมู่ 6 ถนนสายบางหมาก-สนามบิน ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 23 พฤษภาคม 2568

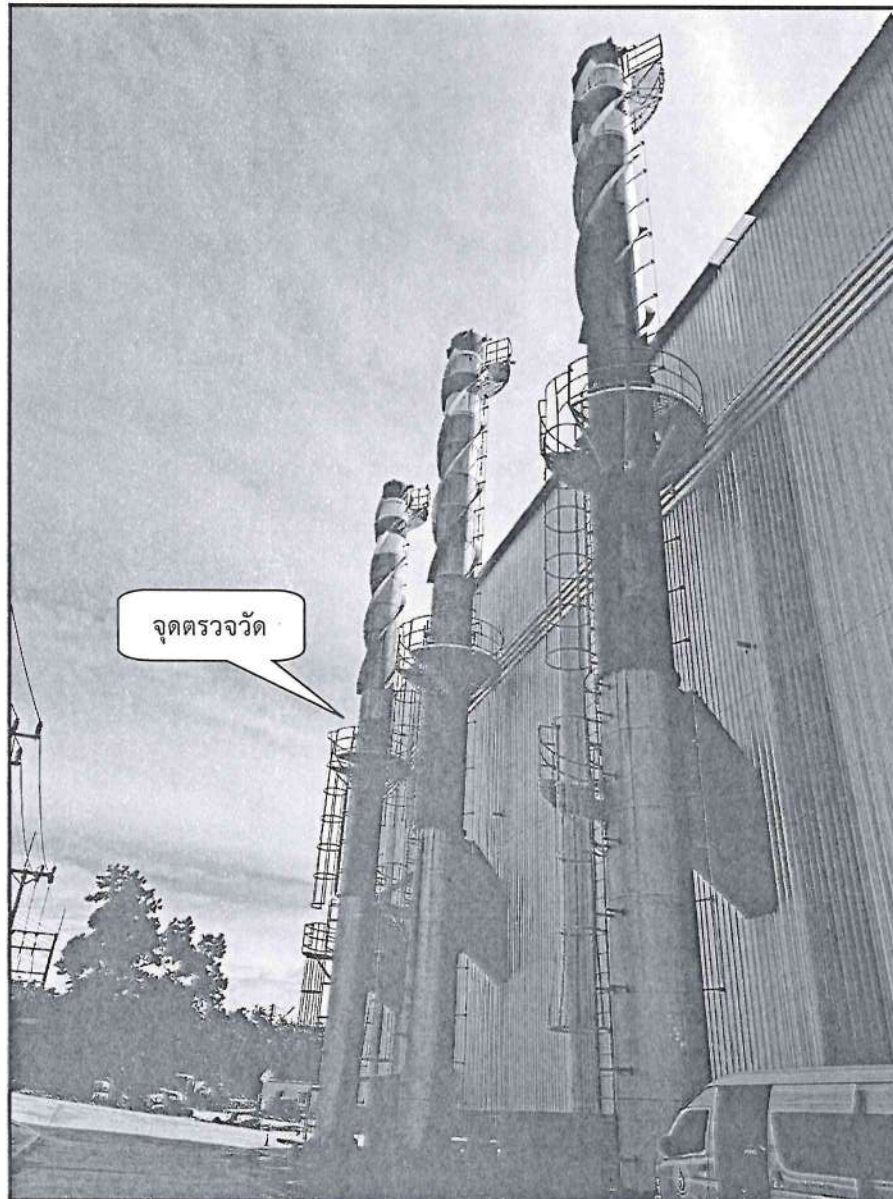

จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง F (GPS : N 7.498453 E 99.577786)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680526-00068